

検査報告書

2024年5月1日

ABC電機株式会社 御中

この度は、ご購入いただきまして誠にありがとうございます。
今回弊社から納入する商品は、正規代理店以外のルートから仕入れた流通在庫品です。
万一の不具合に備えて発送前に弊社の方で検査を行いました。以下に報告させていただきます。

検査判定	合格	品質レベル	A
------	----	-------	---

判定基準

S : 高品質で納品可能。

A : 納品可能。

B : 早急な合否判断を要する。

メーカー名	HARRIS	商品名	HD3-6409-9	数量	20
-------	--------	-----	------------	----	----

外観画像 (マイクロスコープ / デジタルカメラ)

画像 1




画像 2




画像 3



X線画像

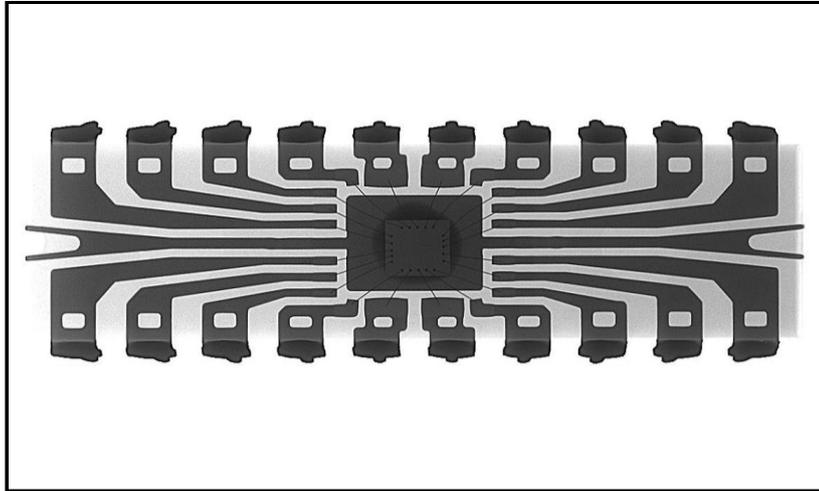

端子間特性画像

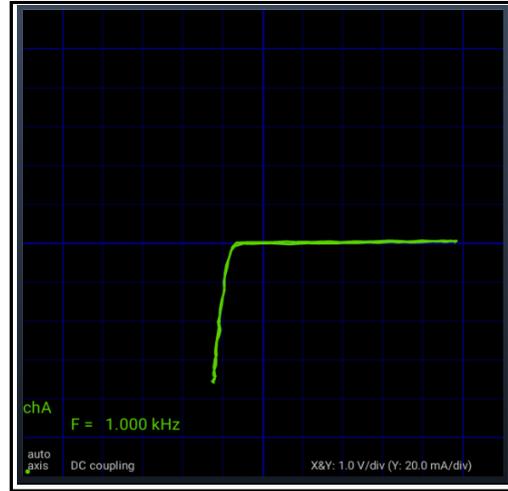

伝達事項

判定は商品の正常動作を保証する内容ではございません。
商品が到着しましたら、ユーザー様の方で少量から動作確認をしていただきますよう、お願い申し上げます。